

ST1™ un ST1-X™ sēriju nestuves

Lietošanas rokasgrāmata




















REF 6300









CE

LV

Apzīmējumi

	Skatīt instrukciju rokasgrāmatu/bukletu
	Lietošanas norādījumi/Skatīt lietošanas pamācību
	Vispārējs brīdinājums
	Uzmanību!
	Brīdinājums; roku iespiešanas risks
	Nestumt
	Neeļļot
	Kataloga numurs
	Sērijas numurs
	ASV patentus skatīt www.stryker.com/patents
	CE marķējums
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Eiropas medicīniskā ierīce
	Ražotājs (XXXX norāda ražošanas gadu)
	Droša darba slodze
	Maksimālais pacienta svars
	Aprīkojuma masa ar drošu darba slodzi
	B tipa pielietojamā daļa
	Mazgāt ar rokām

	Nežāvēt veļas žāvētājā
	Nepakļaut ķīmiskai tīrīšanai
	Negludināt
	Ļaut pilnībā nožūt gaisā
	Hloru saturošs balinātājs
	Eļļot

Saturs

Definīcijas norādēm brīdinājums/uzmanību/piezīme	2
Kopsavilkums par drošības pasākumiem	3
Iespiešanas vietas	5
Ievads	6
Izstrādājuma apraksts	6
Indikācijas lietošanai	6
Klīniskie ieguvumi	7
Sagaidāmais kalpošanas ilgums	7
Paredzētais kalpošanas ilgums	7
Likvidēšana/nodošana pārstrādei	7
Kontrindikācijas	7
Specifikācijas	7
Izstrādājuma ilustrācija	9
Pielietojamās daļas	10
Kontaktinformācija	10
Sērijas numura atrašanās vieta	11
Sērijas numura atrašanās vieta	11
Uzstādīšana	12
Matrača sagatavošana	12
Lietošana	13
Bremžu iedarbināšana un atbrīvošana	13
Pamatnes vadības ierīces	14
Gultas pacelšana	15
Gultas nolaišana	15
Izstrādājuma novietošana Trendelenburga pozīcijā	15
Izstrādājuma novietošana apgrieztā Trendelenburga pozīcijā	16
Pacienta pārvadāšana izstrādājumā ar ievelkamo piekto riteni	16
Pacienta pārvietošana no vienas virsmas uz otru	16
Galvgaļa stumšanas rokturu uzlikšana vai noņemšana	17
Kājgaļa stumšanas rokturu uzlikšana vai noņemšana	17
Sānu balsta pacelšana	18
Sānu balsta nolaišana	19
Faulera muguras balsta pacelšana vai nolaišana	19
Priekšmetu uzglabāšana pamatnes pārsegā	19
Papildu izvēles pastāvīgi piestiprinātā divu posmu IV statīva pozicionēšana	21
Papildu izvēles pastāvīgi piestiprinātā trīs posmu IV statīva pozicionēšana	21
Piederumi un daļas	23
Defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja piestiprināšana	23
Noņemamā IV statņa piestiprināšana un noņemšana	24
Vertikālā skābekļa balona turētāja piestiprināšana	25
Papīra ruļļa turētāja piestiprināšana	26
Pacienta ierobežošanas siksnu pievienošanas vietu atrašana	28
Rentgena kasešu ievietošana vai izņemšana	28
Tīrīšana	30
Izstrādājuma tīrīšana	30
Joda traipu noņemšana	30
Īpaši norādījumi	31
Matrača tīrīšana	31
Izstrādājuma dezinfekcija	32
Matrača dezinfekcija	32
Profilaktiskā apkope	34
Ievelkamā piektā riteņa eļļošana	35

Definīcijas norādēm brīdinājums/uzmanību/piezīme

Norādes **BRĪDINĀJUMS**, **UZMANĪBU** un **PIEZĪME** ir lietotas īpašā nozīmē, tāpēc rūpīgi izlasiet turpmāko.

BRĪDINĀJUMS

Brīdina lasītāju par situāciju, kas (ja to nenovērš) var izraisīt nāvi vai smagu ievainojumu. Šī norāde var aprakstīt arī iespējamās smagas nevēlamās reakcijas un drošības apdraudējumus.

UZMANĪBU

Brīdina lasītāju par iespējami bīstamu situāciju, kas (ja to nenovērš) lietotājam vai pacientam var izraisīt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus vai izstrādājuma vai cita veida īpašuma bojājumus. Tas ietver īpašu piesardzību, kas jāievēro, lai nodrošinātu ierīces drošu un efektīvu lietošanu, kā arī piesardzību, kas jāievēro, lai izvairītos no lietošanas vai nepareizas lietošanas izraisīta bojājuma ierīcei.

Piezīme - Sniedz īpašu informāciju, lai atvieglotu apkopi vai padarītu svarīgas instrukcijas skaidrākas.

Kopsavilkums par drošības pasākumiem

Vienmēr izlasiet un stingri ievērojiet šajā lappusē sniegtos brīdinājumus un piesardzības pasākumus. Servisu uzticiet tikai kvalificētam personālam.

BRĪDINĀJUMS

- Pirms uzstādīšanas vai darba funkciju pārbaudes vienmēr ļaujiet izstrādājumam sasniegt istabas temperatūru. Pretējā gadījumā var rasties paliekoši izstrādājuma bojājumi.
- Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu tikai tad, ja visi operatori atrodas atstatu no mehānismiem.
- Uz Stryker 6300 **ST1** modeļa un **ST1-X** sērijas nestuvēm vienmēr izmantojiet matraci (6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103 vai 6300-0-104). Visu citu matraču izmantošana var izraisīt pacienta ievainojumu.
- Vienmēr ievērojiet piesardzību, ja lietojat matraci, kas ir biezāks par 6,35 cm (2,5 collām) ar **ST1-X** iespēju. Ieteicama operatora uzraudzība, lai samazinātu pacienta kritiena risku mazāka sānu balstu seguma dēļ.
- Ar matraci vienmēr lietojiet gultas veļu.
- Neduriet matrača pārvalkā adatas. Pa caurumiem matrača iekšpusē (iekšējā slānī) var iekļūt ķermeņa šķidrums un radīt savstarpēju piesārņojumu vai bojāt izstrādājumu.
- Matraci vienmēr izmantojiet ar saderīgu rāmi, kā norādīts šīs rokasgrāmatas specifiskācijas sadaļā.
- Vienmēr iedarbiniet bremzes, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma, vai atstāj to, vai kad izstrādājums nav kustībā. Ja izstrādājums pārvietojas, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma vai atstāj to, pacients var gūt ievainojumu.
- Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
- Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltniem un nofiksētiem sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
- Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
- Nesēdiet uz izstrādājuma gala. Izstrādājums var apgāzties.
- Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski zemākajā stāvoklī.
- Lai izvairītos no apgāšanas, nepārvietojiet izstrādājumu sāniski pa slīpumu, kas pārsniedz 6 grādus (10%). Vienmēr pārliecinieties, ka gulta ir horizontāla (neatrodas Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcijā) zemākajā augstumā, kad pārvietojat pacientu.
- Vienmēr iedarbiniet bremzes kā virsmai, uz kuras atrodas pacients, tā arī virsmai, uz kuru pacients tiks pārvietots, pirms pārvietojat pacientu no vienas pacienta atbalsta platformas (gultas, nestuvēm, ratiņiem, operāciju galda) uz citu pacienta atbalsta platformu.
- Vienmēr pārliecinieties, ka pacienta atbalsta platformas ir vienā augstumā, pirms pārvietojat pacientu.
- Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no kājgaļa stumšanas rokturiem, ja izmantojat defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju vai vertikālā skābekļa balona turētāju.
- Kad paceļat vai nolaižat sānu balstu, vienmēr turiet pacienta locekļus atstatu no sānu balsta vārpstām.
- Neļaujiet sānu balstiem brīvi nokrist.
- Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturiem un Faulera muguras atbalsta rāmja, kad nolaižat Faulera muguras atbalstu.
- Vienmēr esiet uzmanīgi, kad paceļat pneimatisko Faulera muguras atbalstu, kad pacients atrodas uz izstrādājuma. Izmantojiet pareizus celšanas paņēmienus un, ja nepieciešams, saņemiet palīdzību.
- Nenovietojiet lietas starp Faulera muguras atbalstu un gultas rāmi, kad Faulera muguras atbalsts ir pacelts.
- Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg.
- Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz 4,5 kg.
- Vienmēr pārliecinieties, ka IV statnis ir zemā augstumā, lai izkļūtu pa durvīm, kad pārvietojat pacientu.
- Neizmantojiet IV statni kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
- Piederumu montāža un uzstādīšana vienmēr jāveic kvalificētam personālam.
- Vienmēr esiet uzmanīgi, ja piestiprināta defibrilatora paplāte/pierakstu turētājs vai vertikālā skābekļa balona turētājs, lai izvairītos no pirkstu iespiešanas, kad pārvietojat kājgaļa papildu izvēles stumšanas rokturi.
- Nenovietojiet uz defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja lietas, kas pārsniedz drošo 14 kg darba slodzi.
- Neizmantojiet defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
- Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 6 kg.
- Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 3 kg.


- Nenovietojiet lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg, visu veidu vertikālā skābekļa balona turētājos.
- Neizmantojiet vertikālā skābekļa balona turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
- Neizmantojiet papīra ruļļa turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
- Neuzkariet uz papīra ruļļa turētāja lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 1,5 kg.
- Vienmēr esiet uzmanīgi, kad piestiprināt ierobežošanas siksnas. Var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Fiziskie ierobežojumi, pat ja tie ir nodrošināti, var izraisīt nopietnu kaitējumu pacientiem un operatoriem, ieskaitot sapīšanas, iesprūšanu, fizisku traumu vai nāvi.
- Vienmēr piestipriniet ierobežošanas siksnas vai ierīces tikai norādītās piestiprināšanas vietās uz izstrādājuma. Pretējā gadījumā var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Nepiestipriniet ierobežošanas siksnas pie sānu balstiem.
- Vienmēr iepazīstieties ar attiecīgiem vietējiem un valsts ierobežojumiem un regulām, un atbilstošiem iestādes protokoliem, pirms izmantojat jebkādu ierobežojuma siksnu vai ierīci.
- Vienmēr pārlūkojiet piemērojamās vietēs un valsts drošības ierobežojumus un regulas, pirms lietojat rentgena papildu izvēli ar starojumu izdalošām ierīcēm. Starojumu izdalošās ierīces var radīt paliekošu, novirzījušu vai izkliedētu starojumu.
- Esiet vienmēr piesardzīgi, kad veicat rentgenuzņēmumu ar Faulera muguras balstu vertikālā stāvoklī vai izmantojat laterālu kaseti.
- Nemazgājiet šī matrača iekšējās daļas. Ja piesārņojums iekļuvis iekšpusē, izmetiet matraci.
- Neieņemci matraci tīrīšanas vai dezinfekcijas šķīdumos.
- Neļaujiet šķīdumam sakrāties uz matrača.
- Negludiniet, nefīriet ķīmiski un nežāvējiet automātiskajos žāvētājos matrača pārvalku.
- Neveiciet izstrādājuma tīrīšanu, apkopi vai remontu laikā, kad izstrādājums tiek lietots.
- Nefīriet izstrādājumu ar tvaiku, ūdens strūklu vai ultraskaņu. Šīs tīrīšanas metodes nav ieteicamas un var anulēt šī izstrādājuma garantiju.
- Lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma un infekcijas riska, vienmēr dezinficējiet matraci saskaņā ar jūsu slimnīcas protokoliem.
- Šī izstrādājuma dezinfekcijai neizmantojiet **Virex® TB**.
- Neizmantojiet paātrinātas darbības ūdeņraža peroksīda dezinfekcijas līdzekļus vai četrvērtīgā amonija dezinfekcijas līdzekļus, kas satur glikolēterus, jo tie var bojāt matrača pārvalku.
- Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, vienmēr apskatiet matraci. Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, ievērojiet slimnīcas protokolus un veiciet profilaktisku apkopi. Ja matracis ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un nomainiet izstrādājumu, lai neļautu rasties krusteniskajam piesārņojumam.

UZMANĪBU!

- Ja izstrādājums tiek lietots nepareizi, pacients vai lietotājs var gūt ievainojumu. Šo izstrādājumu lietojiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Nepārveidojiet izstrādājumu vai jebkuru no tā daļām. Izstrādājuma pārveidošana var izraisīt iespējamu neparedzētu darbību, kā rezultātā pacients vai lietotājs var gūt ievainojumus. Izstrādājuma pārveidošana arī anulē tā garantiju.
- Vienmēr pārvietojiet **ST1** un **ST1-X** sēriju nestuves pa koka, betona vai keramisko flīžu grīdām. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku materiālu, lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes, relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30%.
- Neizmantojiet hidraulisko pacelēju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta pacelējs.
- Neievietojiet lietas, kuru svars pārsniedz 60 lb (27 kg) pamatnes pārsegā.
- Nesēdiet, nekāpiet vai nestāviet uz pamatnes pārsega.
- **ST1** un **ST1-X** sēriju nestuvēm vienmēr lietojiet apstiprinātus piederumus.
- Vienmēr lietojiet matrača pārvalku 6300-1-000 uz putuplasta pamatnes.
- Vienmēr noteikti noslaukiet izstrādājumu ar tīru ūdeni. Katru izstrādājumu pēc tīrīšanas nožāvējiet. Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.
- Nelietojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus ar agresīvām ķīmikālijām, jo tie samazinās matrača pārvalka sagaidāmo kalpošanas ilgumu.
- Tīrot matrača apakšējo daļu, neļaujiet šķīdumam iesūkties rāvējslēdzēja zonā vai ūdensnecaurlaidīgajā apmalē. Šķīdumi, kas saskaras ar rāvējslēdzēju, var iekļūt matrača iekšpusē.
- Pirms uzglabāšanas, gultas veļas uzklāšanas vai pacienta guldināšanas uz virsmas vienmēr ļaujiet matrača pārvalkam nožūt. Sauss izstrādājums palīdz novērst tā pasliktinātu veiktspēju.

- Nepakļaujiet matrača pārvalku augstas koncentrācijas dezinfekcijas līdzekļu šķīdumu ilgākai iedarbībai, jo tie var bojāt matrača pārvalku.
 - Ja netiek ievēroti ražotāja tīrīšanas norādījumi un kompānijas Stryker lietošanas norādījumi, var tikt ietekmēts matrača kalpošanas laiks.
-

Iespēšanas vietas

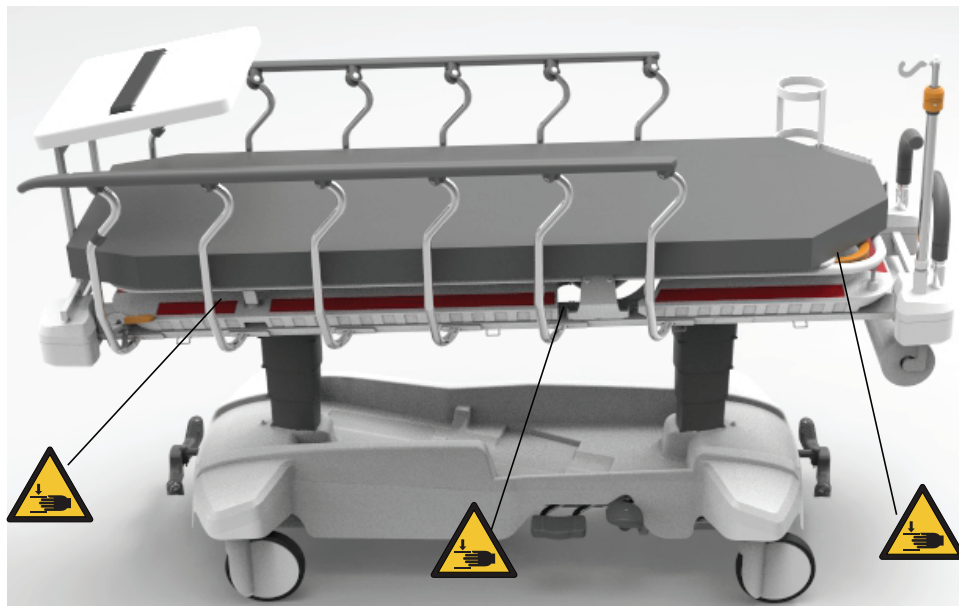

Attēls 1 – iespēšanas vietas (tikai izstrādājumam ar rentgena papildu iespēju)

levads

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par Stryker izstrādājuma darbību un apkopi. Pirms izstrādājuma izmantošanas vai apkopes izlasiet šo rokasgrāmatu. Lai izglītotu un apmācītu personālu, kā droši strādāt ar izstrādājumu un veikt tā apkopi, ieviesiet metodes un procedūras personāla apmācībai.

UZMANĪBU!

- Nepareiza izstrādājuma lietošana var traumēt pacientu vai operatoru. Ar izstrādājumu strādājiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
 - Nepārveidojiet izstrādājumu vai tā sastāvdaļas. Izstrādājuma pārveidošana var radīt neparedzamu tā darbību, kas var traumēt pacientu vai operatoru. Izstrādājuma pārveidošana atceļ arī tā garantiju.
-

Piezīme

- Šī rokasgrāmata ir neatņemama izstrādājuma sastāvdaļa, un tā jāpievieno izstrādājumam pat tad, ja tas tiek pārdots.
- Kompānija Stryker nepārtraukti uzlabo izstrādājuma dizainu un kvalitāti. Šajā rokasgrāmatā iekļauta jaunākā informācija par izstrādājumu, kas ir bijusi pieejama iespēšanas laikā. Iespējamās nelielas atšķirības starp izstrādājumu un informāciju šajā rokasgrāmatā. Ja Jums rodas jautājumi, sazinieties ar kompānijas Stryker Klientu apkalpošanas nodaļu vai Tehniskās palīdzības nodaļu, zvanot pa tālruni 1-800-327-0770.

Izstrādājuma apraksts

Stryker 6300 **ST1** modeļa un **ST1-X** sērijas nestuves ir ar riteņiem aprīkota iekārta, kas sastāv no platformas, uzmontētas uz ar riteņiem aprīkota rāmja, lai atbalstītu pacientus horizontālā stāvoklī. Nestuves nodrošina operatoram metodi pacientu pārvadāšanai veselības aprūpes iestādes iekšējās veselības aprūpes speciālistiem vai apmācītiem iestādes pārstāvjiem. Stryker 6300 **ST1** modeļa un **ST1-X** sērijas nestuves ar ievēljamu piekto riteņi optimizē vilkšanu un stūru apbraukšanu, lai uzlabotu vispārējo kustīgumu.

Indikācijas lietošanai

Nestuves paredzētas lietošanai medicīniski ķirurģiskos apstākļos pacientiem, kuri ir viegli līdz kritiski slimi. Nestuves paredzētas lietošanai slimnīcās, medicīnas iestādēs un klīnikās kā īslaicīga ambulatoro slimnieku novērtēšanas, ārstēšanas, nelielu procedūru izpildes un īslaicīgas atveseļošanās platforma. Nestuves var lietot arī mirušu pacientu pārvietošanai slēgtā veselības aprūpes iestādē. Nestuvju lietotāji var būt veselības aprūpes speciālisti (piemēram, medicīnas māsas, medicīnas māsu palīgi un ārsti) un apkārtējie, kas var izmantot gultas kustību funkcijas (servisa vai apkopes personāls).

Nestuves var izmantot ne tikai, bet arī:

- neatliekamās palīdzības (NP) nodaļā;
- traumatoloģijas nodaļā;
- pēcanestēzijas aprūpes nodaļā (PAN).

ST1 un **ST1-X** sēriju nestuvju rāmis, pie gultas uzstādītie piederumi, matračī un sānu balsti var saskarties ar cilvēka ādu.

Paredzētās lietošanas vides apstākļus skatiet specifikāciju tabulā.

ST1 un **ST1-X** sēriju nestuves nav paredzētas ilglaicīgai (ilgākai par 24 stundām) lietošanai stacionāru pacientu ārstēšanai un atveseļošanai.

Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot veselības aprūpei mājas apstākļos, kā sterilu izstrādājumu, mājas veselības kopšanas vidē, uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē, kā atbalstu pacientam, kurš guļ pozīcijā uz vēdera, pacientiem ar nestabiliem mugurkaula smadzeņu ievainojumiem, vai ar skābekļa telti.

ST1-X sērijas nestuves ar rentgena papildu izvēli nodrošina gan radiogrāfisku atbalsta virsmu ar šarnīra pievienojumu, gan platformu zem pacienta atbalsta virsmas rentgena kasetes ievietošanai. **ST1-X** sērijas nestuves ar rentgena izmeklējumu papildu izvēli ļauj tvert klīniskas rentgenogrammas (anatomiju un fizioloģiju visam ķermenim, papildu izvēlē visam ķermenim laterāli, papildu izvēlē krūškurvim vertikālā stāvoklī), lietojot ar medicīnisku rentgena sistēmu.

Klīniskie ieguvumi

Pacientu transportēšana, ārstēšanas un diagnosticēšanas uzlabošana

Sagaidāmais kalpošanas ilgums

ST1 un ST1-X sērijas nestuvēm ar izvēles rentgena paliktni paredzamais kalpošanas laiks ir 10 gadi parastos lietošanas apstākļos un ar atbilstošu periodisku apkopi.

Ritenīšu minimālais paredzamais kalpošanas laiks ir 5 gadi un ir atkarīgs no normālas lietošanas, apstākļiem, un ar atbilstošu periodisku apkopi.

Paredzētais kalpošanas ilgums

ST1™ un ST1-X™ putuplasta matrača paredzētais kalpošanas ilgums, to lietojot parastā veidā, parastos lietošanas apstākļos un veicot periodisku apkopi, ir 1 gads.



Likvidēšana/nodošana pārstrādei

Vienmēr ievērojiet pašreizējās vietējās rekomendācijas un/vai noteikumus par vides aizsardzību un riskiem, kas saistīti ar aprīkojuma nodošana pārstrādei vai likvidēšanu pēc tā kalpošanas laika beigām.

Kontrindikācijas

Nav zināmas.

Specifikācijas





	Droša darba slodze nozīmē pacienta, matrača un piederumu kopējo svaru	250 kg
	Maksimālais pacienta svars	215 kg
Kopējais garums		2170 mm ± 10 mm
Kopējais platums (sānu balsti pacelti)		790 mm ± 10 mm
Kopējais platums (sānu balsti nolaisti)		735 mm
Augstums	Nav piemērots rentgenam	Piemērots rentgenam
Minimālais augstums	560 mm + 15 mm, -25 mm	610 + 15 mm, -25 mm
Maksimālais augstums	860 ± 10 mm	910 ± 10 mm
Faulera atbalsta leņķis		No 0° līdz 90° (± 5°)
Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcija		+16°/-16° (± 3°)
Minimālais klīrens	Nominālais	15,4 cm ± 5 mm
	Zem hidrauliskajiem domkratiem	4,6 cm ± 5 mm

Saderīgie matračī	6300-0-100	6300-0-102	6300-0-103	6300-0-104
Garums	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm
Platums	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Biezums	8 cm	10 cm	8 cm	10 cm
Svars	3,7 ± 1,0 kg	4,4 ± 1,0 kg	4,3 ± 1,0 kg	4,8 ± 1,0 kg
Putuplasts	Poliuretāns	Poliuretāns	Poliuretāns	Poliuretāns
Pārvalks	Ar poliuretānu un poliamīdu pārklāts poliesteris	Ar poliuretānu un poliamīdu pārklāts poliesteris	Ar poliuretānu un poliamīdu pārklāts poliesteris	Ar poliuretānu un poliamīdu pārklāts poliesteris
Modelis ar liesmu barjeru	Nē	Nē	Jā	Jā

Piezīme

- Informāciju par atbilstošajiem uzliesmojamības standartiem skatīt matrača etiķetē.
- Šis izstrādājums nav piemērots lietošanai uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījuma ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksidula klātbūtnē.
- Minētās specifikācijas ir aptuvenas un var nedaudz mainīties atkarībā no izstrādājuma.



Stryker patur tiesības mainīt specifikācijas bez brīdinājuma.

Vides apstākļi	Lietošana	Uzglabāšana un transportēšana
Temperatūra		
Relatīvais mitrums		

Saskaņā ar Eiropas REACH regulu un citām vides regulatīvajām prasībām uzskaitītas sastāvdaļas, kas satur deklarējamās vielas.


Apraksts	Numurs	Vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), ķīmiskais nosaukums
2 posmu IV statnis	HM-19-108	bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)
3 posmu IV statņa montāža	HM-19-115	bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

Izstrādājuma ilustrācija

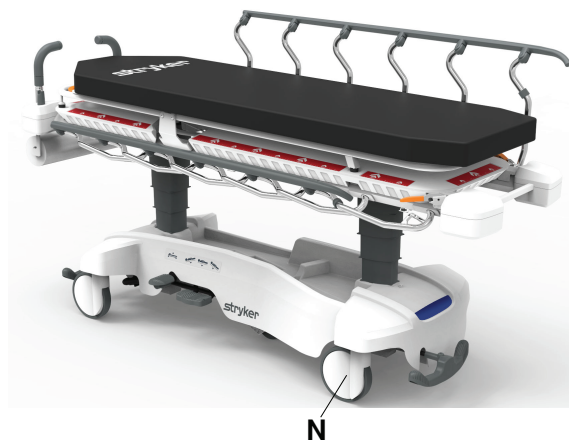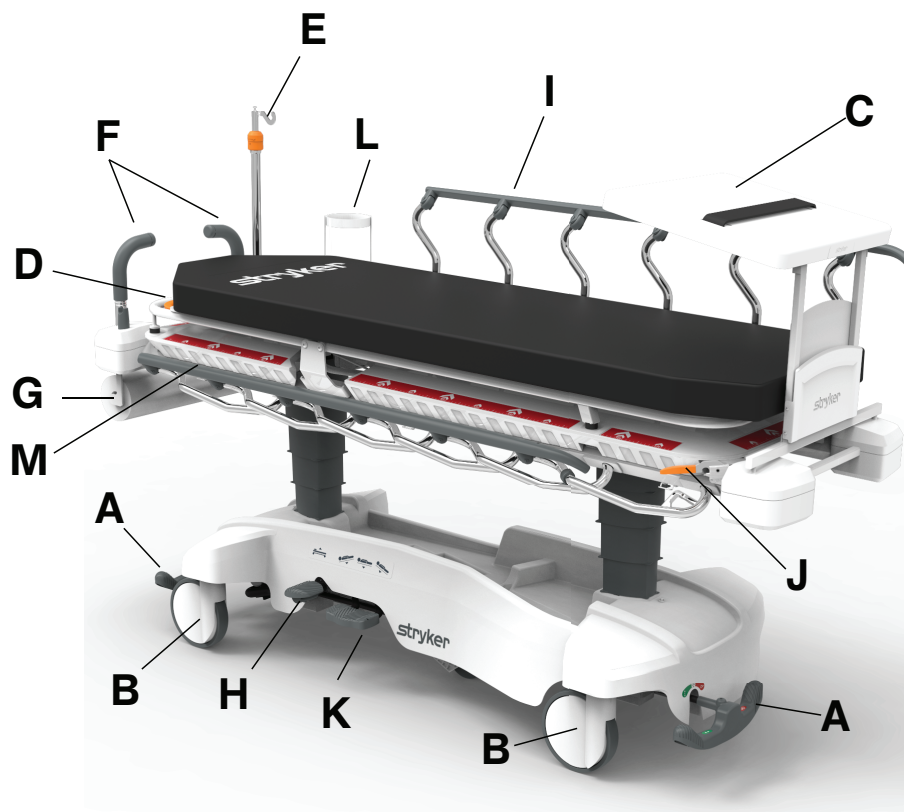

A	Bremzēšanas/stūrēšanas vadības pedālis	H	Sūkņa pedālis
B	Ritenītis	I	Sānu balsts
C	Defibrilatora paplātes/pierakstu turētājs	J	Sānu balsta atbrīvošanas rokturis
D	Faulera atbalsta atbrīvošanas rokturis	K	Universālais nolaišanas pedālis
E	IV statnis	L	Vertikālā skābekļa balona turētājs
F	Pacelšanas stumjamais rokturis	M	Rentģena komplekts
G	Papīra ruļļa turētājs	N	Antistatiskais ritenītis

Pielietojamās daļas

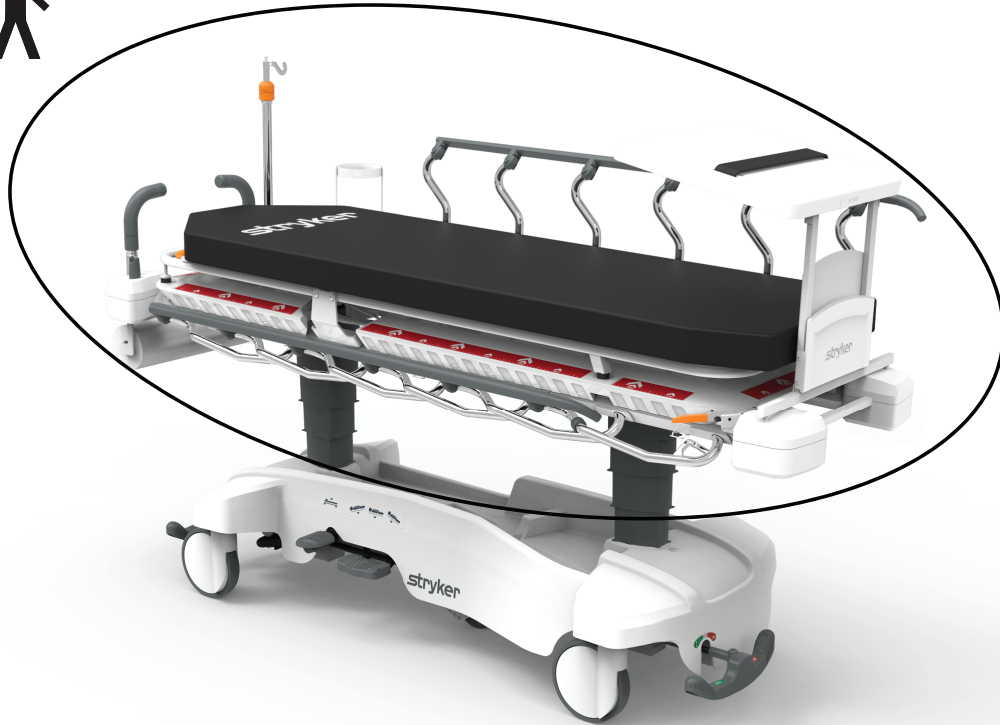

Attēls 2 – B tipa pielietojamās daļas

Kontaktinformācija

Sazinieties ar Stryker klientu atbalsta dienestu vai tehniskās palīdzības dienestu: tālrunis +1 800-327-0770.

Stryker Medical International
Kayseri Serbest Bölge Şubesi
2. Cad. Nr.:17 38070
Kayseri, Turcija

E-pasts: infosmi@stryker.com

Tālrunis: + 90 (352) 321 43 00 (privātajiem klientiem)

Fakss: + 90 (352) 321 43 03

Tīmekļa vietne: www.stryker.com

Piezīme - Galalietotājam un/vai pacientam ir jāziņo par jebkuriem ar izstrādājumu saistītiem nopietniem negadījumiem ražotājam un galalietotāja un/vai pacienta mītnes Eiropas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Lietošanas vai apkopes rokasgrāmatu tiešsaistē skatiet vietnē <https://techweb.stryker.com/>.

Zvanot Stryker Klientu apkalpošanas dienestam, turiet pieejamu sava Stryker izstrādājuma sērijas numuru (A). Iekļaujiet sērijas numuru visa veida rakstiskā saziņā.


Sērijas numura atrašanās vieta



Attēls 3 – Sērijas numura atrašanās vieta

Sērijas numura atrašanās vieta

Atveriet matrača pārvalka rāvējslēdzēju, lai piekļūtu izstrādājuma etiķetei un sērijas numuram.

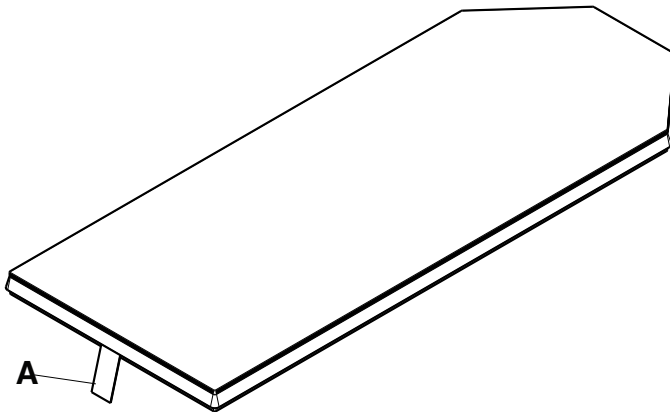

Uzstādīšana

Lai izpakotu izstrādājumu, izlasiet izpakošanas norādījumus, kas pievienoti izstrādājumam transportēšanas kastes iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS

- Pirms uzstādīšanas vai darba funkciju pārbaudes vienmēr ļaujiet izstrādājumam sasniegt istabas temperatūru. Pretējā gadījumā var rasties paliekoši izstrādājuma bojājumi.
- Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu tikai tad, ja visi operatori atrodas atstatu no mehānismiem.
- Uz Stryker 6300 **ST1** modeļa un **ST1-X** sērijas nestuvēm vienmēr izmantojiet matraci (6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103 vai 6300-0-104). Visu citu matraču izmantošana var izraisīt pacienta ievainojumu.
- Vienmēr ievērojiet piesardzību, ja lietojat matraci, kas ir biezāks par 6,35 cm (2,5 collām) ar **ST1-X** iespēju. Ieteicama operatora uzraudzība, lai samazinātu pacienta kritiena risku mazāka sānu balstu seguma dēļ.

UZMANĪBU! - Vienmēr pārvietojiet **ST1** un **ST1-X** sēriju nestuves pa koka, betona vai keramisko flīžu grīdām. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku materiālu, lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes, relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30%.

Pirms sākt lietot izstrādājumu, pārliecinieties, ka tas darbojas.

1. Iedarbiniet bremzi. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka visi četri ritenīši ir bloķēti.
2. Atbloķējiet bremzes. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka visi četri ritenīši ir atbloķēti.
3. Paceliet un nolaidiet gultu ar hidrauliskā pacelēja sistēmu.
4. Paceliet izstrādājumu augstākajā stāvoklī un novietojiet izstrādājumu Trendelenburga pozīcijā. Pārliecinieties, ka galvgalis pilnībā nolaižas uz leju.
5. Paceliet izstrādājumu augstākajā stāvoklī un novietojiet izstrādājumu apgrieztā Trendelenburga pozīcijā. Pārliecinieties, ka kājgalis pilnībā nolaižas uz leju.
6. Iedarbiniet piekto riteni un pārliecinieties, ka piektais ritenis vada un pagriež izstrādājumu.
7. Pārliecinieties, ka sānu balsti ir paceļami, nolaižami un fiksējami vietā.
8. Paceliet un nolaidiet manuālo Faulera muguras balstu (galvas daļu).

Matrača sagatavošana

BRĪDINĀJUMS

- Ar matraci vienmēr lietojiet gultas veļu.
- Neduriet matrača pārvalkā adatas. Pa caurumiem matrača iekšpusē (iekšējā slānī) var iekļūt ķermeņa šķidrumi un radīt savstarpēju piesārņojumu vai bojāt izstrādājumu.
- Matraci vienmēr izmantojiet ar savietojamu rāmi, kā norādīts šīs rokasgrāmatas specifikācijas sadaļā.

Matrača sagatavošana:

1. Novietojiet matraci uz saderīgām nestuvēm.
2. Pārliecinieties, ka matracis novietots ar Stryker logotipu nestuvju kājgalī.
3. Salāgojiet āķa un cilpas stiprinājumu matrača apakšpusē pārklājā ar nestuvju gultas virsmu.
4. Pārliecinieties, ka ūdensizturīgā pārvalka atloki pārklāj rāvējslēdzēju.
5. Pirms izmantošanas pacientam, uzklājiet uz matrača gultas veļu. Ievērojiet jūsu slimnīcas protokolus.

Lietošana

Bremžu iedarbināšana un atbrīvošana

BRĪDINĀJUMS - Vienmēr iedarbiniet bremzes, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma vai atstāj to vai kad izstrādājums nav kustībā. Ja izstrādājums pārvietojas, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma vai atstāj to, pacients var gūt ievainojumu.

Lai iedarbinātu bremzes, nospiediet bremzēšanas/stūrēšanas pedāļa bremzēšanas (sarkano) malu. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka bremzes darbojas.

Lai atbrīvotu bremzes, nospiediet bremzēšanas/stūrēšanas pedāļa stūrēšanas (zaļo) malu.




Attēls 4 – Bremzēšanas/stūrēšanas pedālis

Pamatnes vadības ierīces



Attēls 5 – Bremzēšanas/stūrēšanas pedālis

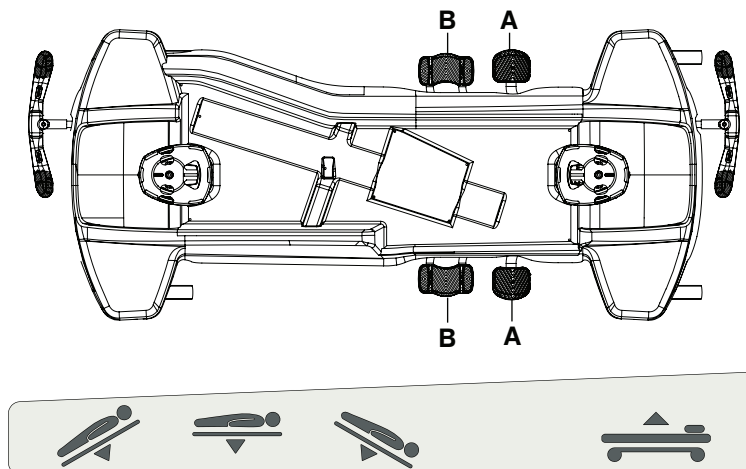

Attēls 6 – Gultas pacelšana ar no nestuvju malas vadāmu hidrauliku

Gultas pacelšana

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
- Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
- Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
- Nesēdiet uz izstrādājuma gala. Izstrādājums var apgāzties.

UZMANĪBU! - Neizmantojiet hidraulisko pacelāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta pacelājs.

Lai paceltu gultu, spiediet uz leju sūkņa pedāli (A), līdz sasniedzat vēlamo augstumu (*Pamatnes vadības ierīces* (lpp. 14)).

Gultas nolaišana

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
- Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
- Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
- Nesēdiet uz izstrādājuma gala. Izstrādājums var apgāzties.

UZMANĪBU! - Neizmantojiet hidraulisko pacelāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta pacelājs.

Lai nolaistu zemāk visu gultu, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) centru (*Pamatnes vadības ierīces* (lpp. 14)).

Lai nolaistu izstrādājuma galvgali, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk izstrādājuma galvgalim.

Lai nolaistu izstrādājuma kājgali, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk izstrādājuma kājgalim.

Izstrādājuma novietošana Trendelenburga pozīcijā

BRĪDINĀJUMS - Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.

UZMANĪBU! - Neizmantojiet hidraulisko pacelāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta pacelājs.

Lai novietotu izstrādājumu Trendelenburga pozīcijā (ar galvu uz leju), paceliet gultu augstākajā stāvoklī (*Gultas pacelšana* (lpp. 15)).

Piezīme - Paceliet gultu augstākajā stāvoklī lielākajam Trendelenburga pozīcijas leņķim.

Lai nolaistu izstrādājuma galvgali, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk galvgalim (*Pamatnes vadības ierīces* (lpp. 14)).

Lai nolaistu izstrādājumu no Trendelenburga pozīcijas, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) centru, līdz gulta izlīdzinās.

Izstrādājuma novietošana apgrieztā Trendelenburga pozīcijā

BRĪDINĀJUMS - Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.

UZMANĪBU! - Neizmantojiet hidraulisko pacelāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta pacelājs.

Lai novietotu izstrādājumu apgrieztā Trendelenburga pozīcijā (ar kājām uz leju), paceliet gultu augstākajā stāvoklī (*Gultas pacelšana* (lpp. 15)).

Piezīme - Paceliet gultu augstākajā stāvoklī lielākajam Trendelenburga pozīcijas leņķim.

Lai nolaistu izstrādājuma kājgalu, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk kājgali (*Pamatnes vadības ierīces* (lpp. 14)).

Lai nolaistu izstrādājumu no apgrieztās Trendelenburga pozīcijas, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) centru, līdz gulta izlīdzinās.

Pacienta pārvadāšana izstrādājumā ar ievēlamo piekto riteni

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
 - Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
 - Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski zemākajā stāvoklī.
 - Lai izvairītos no apgāšanas, nepārvietojiet izstrādājumu sāniski pa slīpumu, kas pārsniedz 6 grādus (10%). Vienmēr pārliedzieties, ka gulta ir horizontāla (neatrodas Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcijā) zemākajā augstumā, kad pārvietojat pacientu.
-

UZMANĪBU! - Neizmantojiet hidraulisko pacelāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta pacelājs.

Lai pārvadātu pacientu ar ievēlamo piekto riteni:

1. Lai iedarbinātu piekto riteni, nospiediet bremzēšanas/stūrēšanas pedāļa stūrēšanas pusi.
2. Lai pārvietotu izstrādājumu sāniski, novietojiet pedāli neitrālā stāvoklī. Pārvietojiet izstrādājumu uz vēlamo vietu.

Piezīme - Nemēģiniet pārvietot izstrādājumu sāniski ar iedarbinātu ievēlamo piekto riteni.

3. Lietojiet bremzes, lai nofiksētu izstrādājumu vietā.

Piezīme - Lai izvairītos no operatora vai pacienta ievainojuma, vienmēr pārliedzieties, ka bremze ir atbloķēta, pirms veicat pārvietošanu.

Pacienta pārvietošana no vienas virsmas uz otru

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr iedarbiniet bremzes kā virsmai, uz kuras atrodas pacients, tā arī virsmai, uz kuru pacients tiks pārvietots, pirms pārvietojat pacientu no vienas pacienta atbalsta platformas (gultas, nestuvēm, ratiņiem, operāciju galda) uz citu pacienta atbalsta platformu.
 - Vienmēr pārliedzieties, ka pacienta atbalsta platformas ir vienā augstumā, pirms pārvietojat pacientu.
-

Lai pārvietotu pacientu no vienas virsmas uz otru:


1. Iedarbiniet bremzes. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliedzītos, ka bremzes darbojas.
2. Nolaidiet sānu balstu malā, kas vērsta pret salāgoto atbalsta virsmu, viszemākajā stāvoklī.
3. Pārvietojiet pacientu uz salāgoto atbalsta virsmu.

4. Paceliet sānu balstu vertikāli un nostipriniet.


Galvgaļa stumšanas rokturu uzlikšana vai noņemšana

Lai uzliktu vai noņemtu galvgaļa stumšanas rokturus:

1. Velciet tieši uz augšu galvgaļa stumšanas rokturus pa vienam.
2. Pagrieziet galvgaļa stumšanas rokturus (A) lietošanas stāvoklī (Attēls 7).
3. Lai nofiksētu stumšanas rokturus vietā, pastumiet tos uz leju pa vienam.

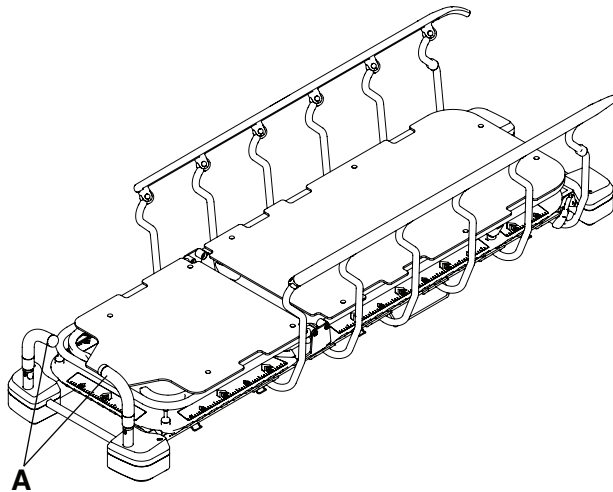

Attēls 7 – Galvgaļa stumšanas rokturu uzlikšana

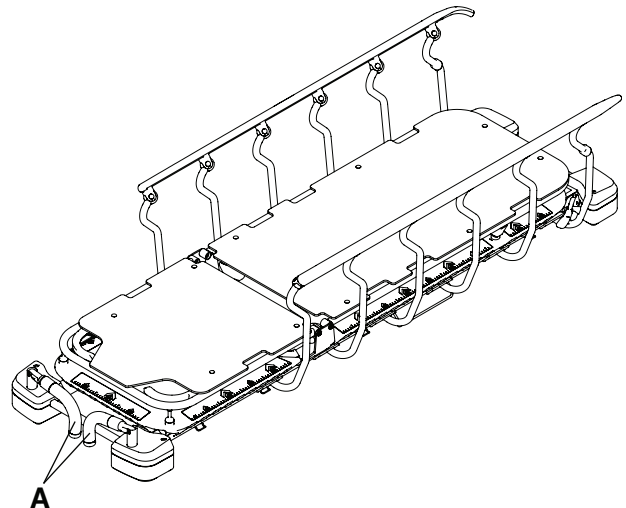

Attēls 8 – Galvgaļa stumšanas rokturu noņemšana

4. Lai noņemtu galvgaļa stumšanas rokturus (A), veiciet soļus apgrieztā secībā (Attēls 8).


Piezīme - Lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem, izmantojiet stumšanas rokturus tikai kā stumšanas/vilkšanas ierīces, ja nav norādīts citādi.

Kājgaļa stumšanas rokturu uzlikšana vai noņemšana


BRĪDINĀJUMS - Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no kājgaļa stumšanas rokturiem, ja izmantojat defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju vai vertikālā skābekļa balona turētāju.

Lai pozicionētu kājgaļa stumšanas rokturus:

1. Velciet tieši uz augšu kājgaļa stumšanas rokturus (A) pa vienam (Attēls 9).
2. Pagrieziet kājgaļa stumšanas rokturus (A) lietošanas stāvoklī.
3. Lai nofiksētu stumšanas rokturus vietā, pastumiet tos uz leju pa vienam.

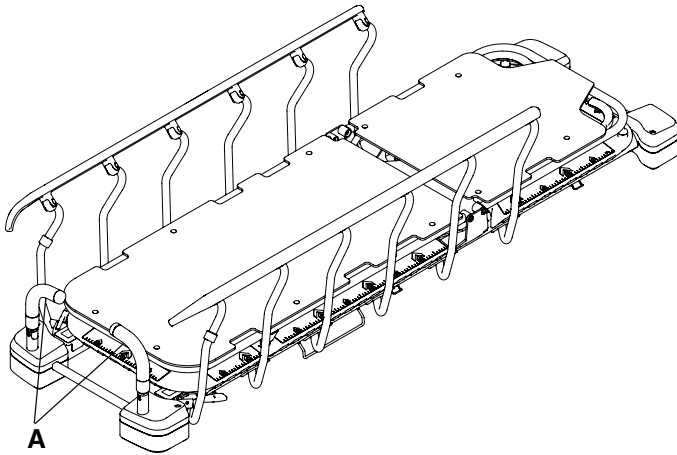

Attēls 9 – Kājgaļa stumšanas rokturu pozicionēšana

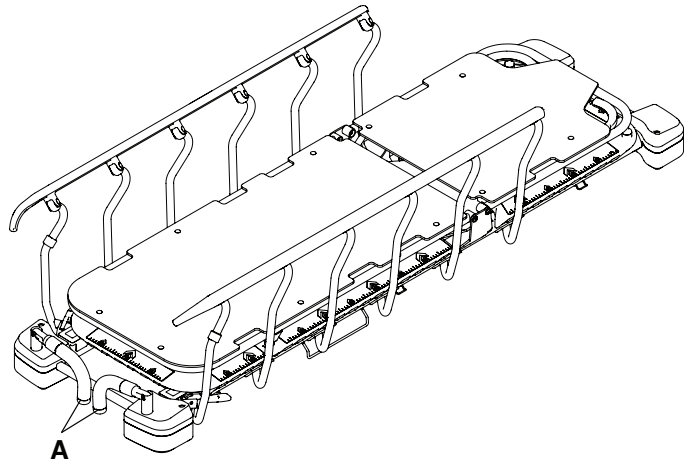

Attēls 10 – Kājgaļa stumšanas rokturu noņemšana

4. Lai noņemtu kājgaļa stumšanas rokturus (A), veiciet soļus apgrieztā secībā (Attēls 10).

Sānu balsta pacelšana

BRĪDINĀJUMS

- Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
- Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski zemākajā stāvoklī.
- Kad paceļat vai nolaižat sānu balstu, vienmēr turiet pacienta locekļus atstatu no sānu balsta vārpstām.
- Neļaujiet sānu balstiem brīvi nokrist.

Lai paceltu sānu balstus:

1. Satveriet sānu balstu ar abām rokām.
2. Paceliet sānu balstu uz izstrādājuma galvgali, līdz atbrīvošanas fiksators ar klikšķi nonāk vietā. Pavelciet sānu balstu, lai pārliecinātos, ka tas ir nofiksēts.

Piezīme

- Neizmantojiet sānu balstus kā ierobežošanas ierīces, lai pacients neizkāptu no gultas. Sānu balsti neļauj pacientam novelties no izstrādājuma. Lietotājam ir jānosaka nepieciešamā ierobežojuma pakāpe, lai garantētu pacienta drošību.
- Jūs varat izmantot sānu balstu kājgali kā stumšanas/vilkšanas ierīci.
- Sānu balsti fiksējas tikai vertikālajā stāvoklī līdz galam.

Sānu balsta nolaišana

BRĪDINĀJUMS

- Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
 - Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski zemākajā stāvoklī.
 - Kad paceļat vai nolaižat sānu balstu, vienmēr turiet pacienta locekļus atstatu no sānu balsta vārpstām.
 - Neļaujiet sānu balstiem brīvi nokrist.
-

Lai nolaistu sānu balstu:

1. Ar vienu roku satveriet sanu balstu.
2. Izmantojiet otru roku, lai paceltu atbrīvošanas fiksatoru.
3. Paceliet un virziet sānu balstu uz izstrādājuma galvgali, līdz atbrīvošanas fiksators ar klikšķi nonāk vietā. Pavelciet sānu balstu, lai pārliecinātos, ka tas ir nofiksēts.

Piezīme

- Neizmantojiet sānu balstus kā ierobežošanas ierīces, lai pacients neizkāptu no gultas. Sānu balsti neļauj pacientam novēlties no izstrādājuma. Lietotājam ir jānosaka nepieciešamā ierobežojuma pakāpe, lai garantētu pacienta drošību.
- Jūs varat izmantot sānu balstu kājgali kā stumšanas/vilkšanas ierīci.
- Sānu balsti fiksējas tikai vertikālajā stāvoklī līdz galam.

Faulera muguras balsta pacelšana vai nolaišana

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu tikai tad, ja visi operatori atrodas atstatu no mehānismiem.
 - Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturiem un Faulera muguras atbalsta rāmja, kad nolaižat Faulera muguras atbalstu.
 - Vienmēr esiet uzmanīgi, kad paceļat pneimatisko Faulera muguras atbalstu, kad pacients atrodas uz izstrādājuma. Izmantojiet pareizus celšanas paņēmienus un, ja nepieciešams, saņemiet palīdzību.
 - Nenovietojiet lietas starp Faulera muguras atbalstu un gultas rāmi, kad Faulera muguras atbalsts ir pacelts.
-

Lai paceltu Faulera muguras atbalstu, saspiediet vienu vai abus Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturus un pavelciet Faulera muguras atbalstu vēlamā stāvoklī (no 0° līdz 80°).


Lai nolaistu Faulera muguras atbalstu, saspiediet vienu vai abus Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturus un pastumiet Faulera muguras atbalstu vēlamā stāvoklī (no 80° līdz 0°).

Priekšmetu uzglabāšana pamatnes pārsegā

UZMANĪBU!

- Neievietojiet priekšmetus, kuru svars pārsniedz 60 mārciņas (27 kg), pamatnes pārsegā.
 - Nesēdiet, nekāpiet un nestāviet uz pamatnes pārsega.
-

Pamatnes pārsegā (A) var uzglabāt pacienta mantas (Attēls 11).

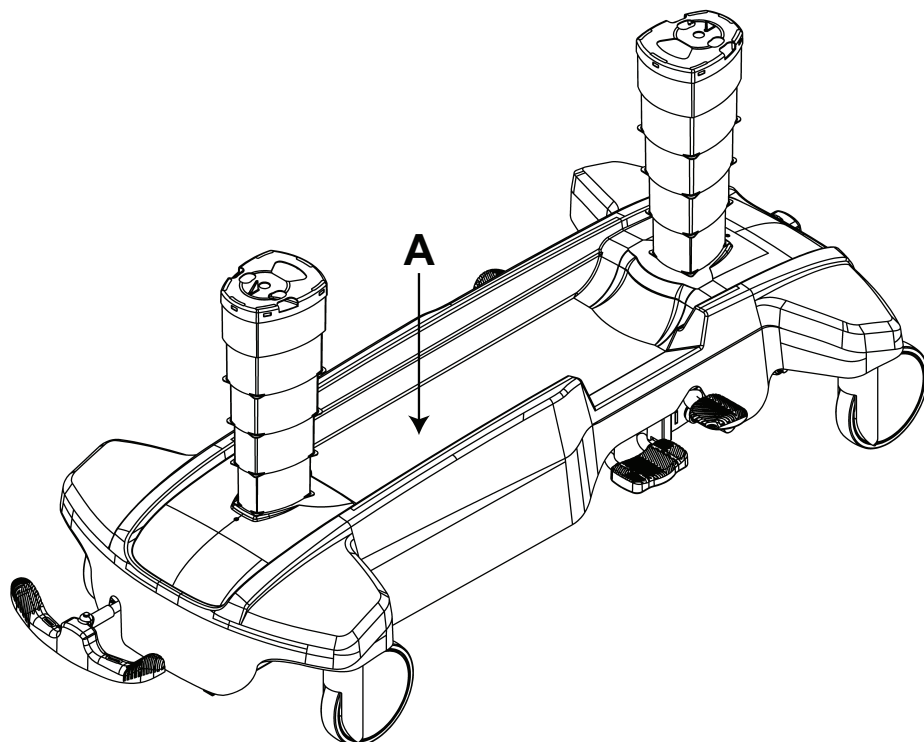

Attēls 11 – Pamatnes pārsega uzglabāšanas vieta

Nestuvju pamatnes pārsegā var uzglabāt starptautisko skābekļa balonu ar šādām specifikācijām:

ST1-X modelim:

- Maksimālais diametrs 14 cm
- Maksimālais garums 90 cm

Specifikācijas	Balona izmēri
Diametrs no 100 līdz 140 mm / garums no 465 līdz 670 mm	3 l, 5 l
Diametrs 140 mm / garums 870 mm	UK-F
Diametrs 140 mm / garums 900 mm	UK HX
Diametrs 140 mm / garums no 420 līdz 900 mm	E
Diametrs 140 mm / garums no 420 līdz 670 mm	C, CD
Francijā 5 l, Vācijā parastais 5 l O2 balons, Eiropas 5 l	

ST1 modelim bez rentgena iespējas:

- Maksimālais diametrs 14 cm
- Maksimālais garums 64 cm

Specifikācijas	Balona izmēri
Diametrs no 100 līdz 140 mm / garums no 465 līdz 640 mm	3 l, 5 l
Diametrs no 100 līdz 140 mm / garums no 420 līdz 640 mm	C, CD
Vācijā parastais 5 l skābekļa balons, Eiropā 5 l	

Papildu izvēles pastāvīgi piestiprinātā divu posmu IV statīva pozicionēšana


BRĪDINĀJUMS

- Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg.
- Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz 4,5 kg.
- Vienmēr pārliecinieties, ka IV statīvs ir zemā augstumā, lai varētu droši izkļūt cauri durvju ailēm, kad pārvietojat pacientu.
- Neizmantojiet IV statīvu kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Jūs varat iegādāties izstrādājumu ar papildu izvēles divu posmu IV statīvu, kas ir pastāvīgi piestiprināts izstrādājuma galvgalī, kājgalī vai abos izstrādājuma galos. IV statīvs ir apgādāts ar teleskopisku statīvu, kas ir izvelkams, lai nodrošinātu otru augstuma stāvokli. Jūs varat salocīt un uzglabāt IV statīvu, kad tas netiek lietots.

Lai pozicionētu divu posmu IV statīvu (Attēls 12):

1. Paceliet un pagrieziet statīvu no uzglabāšanas stāvokļa.
2. Stumiet IV statīvu uz leju, līdz IV statīvs fiksējas vietā.
3. Lai palielinātu IV statņa augstumu, velciet teleskopisko daļu (A), līdz statnis fiksējas vietā augstākajā stāvoklī.
4. Pagrieziet IV pakaramos (B) vēlamā stāvoklī un uzkariniet IV maisus.
5. Lai IV statīvu nolaiestu zemāk, turiet IV statīva teleskopisko daļu, pagrieziet fiksatoru (C) un nolaidiet zemāk teleskopisko daļu.
6. Pavelciet uz augšu IV statni un pagrieziet IV statni uzglabāšanas stāvoklī.

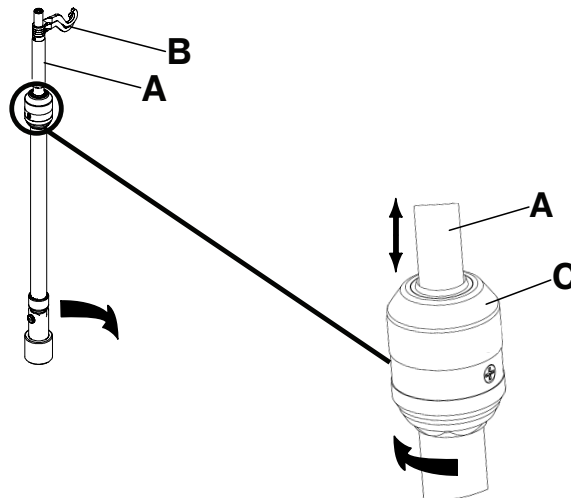

Attēls 12 – Pastāvīgi nostiprināmā divpakāpju IV statņa uzlikšana

Papildu izvēles pastāvīgi piestiprinātā trīs posmu IV statīva pozicionēšana


BRĪDINĀJUMS

- Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg.
- Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz 4,5 kg.
- Vienmēr pārliecinieties, ka IV statīvs ir zemā augstumā, lai varētu droši izkļūt cauri durvju ailēm, kad pārvietojat pacientu.
- Neizmantojiet IV statīvu kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Jūs varat iegādāties izstrādājumu ar papildu izvēles trīs posmu IV statīvu, kas ir pastāvīgi piestiprināts izstrādājuma galvgalī, kājgalī vai izstrādājuma abos galos. IV statīvs ir apgādāts ar teleskopisku statīvu, kas ir izvelkams, lai nodrošinātu otro un trešo augstuma stāvokli. Jūs varat salocīt un uzglabāt IV statīvu, kad tas netiek lietots.

Lai pozicionētu trīs posmu IV statni (Attēls 13):

1. Paceliet un pagriežiet statīvu no uzglabāšanas stāvokļa.
2. Stumiet IV statīvu uz leju, līdz statīvs fiksējas vietā.
3. Lai palielinātu IV statīva augstumu, velciet teleskopisko daļu (A), līdz statīvs fiksējas vietā pilnībā izvirzītā stāvoklī.
4. Lai vēl pagarinātu IV statīvu, pavelciet sekciju (B). Atlaidiet sekciju (B) jebkurā vēlamajā augstumā, lai fiksētu statīvu vietā.
5. Pagriežiet IV pakaramos (C) vēlamā stāvoklī un uzkariniet IV maisus.
6. Lai IV statīvu nolaistu zemāk, pavelciet roktura (D) dzelteni daļu, vienlaikus turot sekciju (B), līdz statīvs samazina augstumu.
7. Pagriežiet fiksatoru (E) un pazeminiet stieņa teleskopisko daļu.

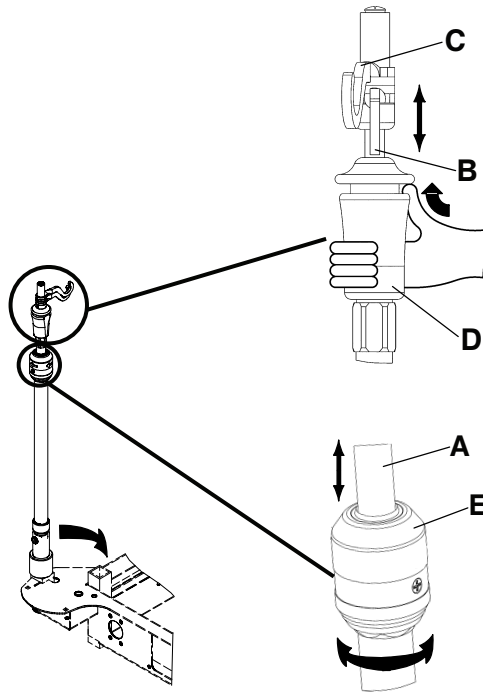

Attēls 13 – Pastāvīgi piestiprinātā trīs posmu IV statīva pozicionēšana

Piederumi un daļas

BRĪDINĀJUMS - Piederumu montāža un uzstādīšana vienmēr jāveic kvalificētam personālam.

UZMANĪBU! - ST1 un ST1-X sēriju nestuvēm vienmēr lietojiet apstiprinātus piederumus.

Lietošanai ar jūsu izstrādājumu var būt pieejami šādi piederumi. Apstipriniet pieejamību atbilstoši jūsu rīcībā esošajai konfigurācijai vai reģionam.


Nosaukums	Daļas numurs
Defibrilatora paplāte ar pierakstu turētāju	MM047
IV statnis, noņemams	MM050
Matracis	6300-0-100
Matracis	6300-0-102
Matracis	6300-0-103
Matracis	6300-0-104
Skābekļa balona turētājs, vertikāls	MM045
Skābekļa balona turētājs, vertikāls	MM044
Skābekļa balona turētājs, vertikāls	MM046
Papīra ruļļa turētājs	MM048
Ierobežošanas sikсна, potīšu	MM052
Ierobežošanas sikсна, ķermenim	MM053
Ierobežošanas sikсна, plaukstas locītavai	MM054
Ierobežošanas sikсну komplekts	MM055

Defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja piestiprināšana

BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr esiet uzmanīgi, ja piestiprināta defibrilatora paplāte/pierakstu turētājs vai vertikālā skābekļa balona turētājs, lai izvairītos no pirkstu iespiešanas, kad pārvietojat kājgaļa papildu izvēles stumšanas rokturi.
- Nenovietojiet uz defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja lietas, kas pārsniedz drošo 14 kg darba slodzi.
- Neizmantojiet defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Lai piestiprinātu defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju, ievietojiet defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja tapas (A) ligzdās izstrādājuma kājgalī.

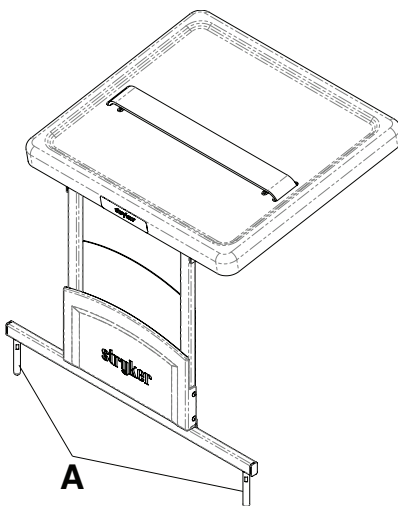

Attēls 14 – Defibrilatora/pierakstu turētāja piestiprināšana

Noņemamā IV statņa piestiprināšana un noņemšana

BRĪDINĀJUMS


- Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 6 kg.
 - Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 3 kg.
 - Neizmantojiet IV statni kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
-

Lai piestiprinātu un novietotu noņemamo IV statni (Attēls 15):


1. Ievietojiet IV statni ligzdā izstrādājuma galvgalī vai kājgalī.
2. Pagrieziet kloķi (A) pretpulksteniski un izvelciet teleskopisko daļu (B), līdz sasniedzat vēlamu augstumu.
3. Pagrieziet kloķi (A) pulksteniski, lai fiksētu teleskopisko daļu vietā.

Piezīme

- Vienmēr pārliedzinieties, ka IV statnis ir zemā augstumā, lai izkļūtu pa durvīm, kad pārvietojat pacientu.
- Pēc IV statņa ievietošanas nestuvju adapterā, lietojiet "Rue ring" tapu.

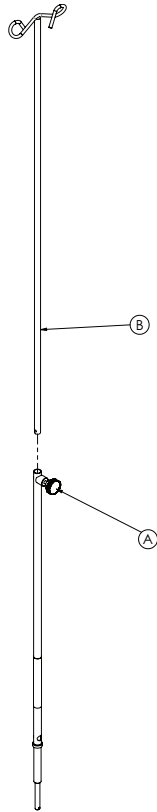

Attēls 15 – Noņemams IV statnis

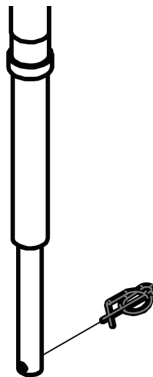

Attēls 16 – "Rue ring" tapa

Vertikālā skābekļa balona turētāja piestiprināšana

BRĪDINĀJUMS


- Nenovietojiet lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg, visu veidu vertikālā skābekļa balona turētājos.
- Vienmēr esiet uzmanīgi, ja piestiprināta defibrilatora paplāte/pierakstu turētājs vai vertikālā skābekļa balona turētājs, lai izvairītos no pirkstu iespiešanas, kad pārvietojat kājgaļa papildu izvēles stumšanas rokturi.
- Neizmantojiet vertikālā skābekļa balona turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Vertikālā skābekļa balona turētājs notur skābekļa balonu vertikālā stāvoklī.

Lai piestiprinātu vertikālā skābekļa balona turētāju:

1. Ievietojiet atbalsta stieni (A) skābekļa balona turētāja ligzdā izstrādājuma galvgalī.

2. Ievietojiet sprosttapu (B) atbalsta stieņa caurumā, lai piestiprinātu balona turētāju izstrādājumam.

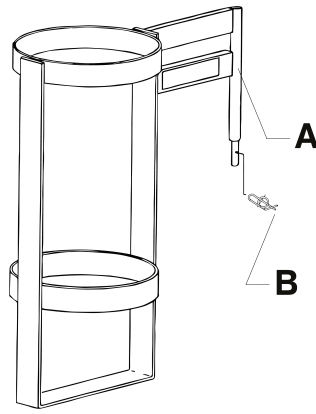

Attēls 17 – Skābekļa balona turētāja piestiprināšana

Piezīme - Vertikālā skābekļa balona turētājs notur šādu izmēru balonus:

Specifikācijas	Daļas numurs
Maksimālais diametrs 120 mm, maksimālais garums 900 mm	MM045
Maksimālais diametrs 120 mm, maksimālais garums 640 mm	MM044
Maksimālais diametrs 140 mm, maksimālais garums 640 mm	MM046

Papīra ruļļa turētāja piestiprināšana


BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet papīra ruļļa turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
- Neuzkariet uz papīra ruļļa turētāja lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 1,5 kg.

Papīra ruļļa turētājs padod papīru kā aizsargslāni uz nestuvju virsmas higiēnas nolūkiem.

Lai piestiprinātu papīra ruļļa turētāju:

1. Izstrādājuma galvgalī novietojiet papīra ruļļa turētāja stieni (B) pret rāmi starp paceļamajiem stumšanas rokturiem.
2. Ar krustiņa skrūvgriezi nostipriniet papīra ruļļa turētāju uz rāmja ar divām pašgriezējām skrūvēm (A; HM-06-121).
3. Uzlieciet papīra rulli uz papīra ruļļa turētāja (C).

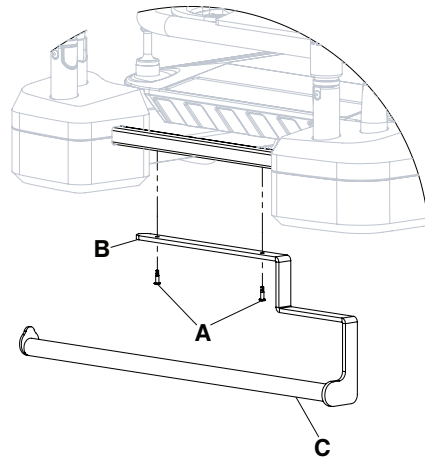


Attēls 18 – Papīra ruļļa turētāja piestiprināšana

Pacienta ierobežošanas siksnu pievienošanas vietu atrašana


BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr esiet uzmanīgi, kad piestiprināt ierobežošanas siksas. Var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Fiziskie ierobežojumi, pat ja tie ir nodrošināti, var izraisīt nopietnu kaitējumu pacientiem un operatoriem, ieskaitot sapīšanos, iesprūšanu, fizisku traumu vai nāvi.
- Vienmēr piestipriniet ierobežošanas siksas vai ierīces tikai norādītās piestiprināšanas vietās uz izstrādājuma. Pretējā gadījumā var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Nepiestipriniet ierobežošanas siksas pie sānu balstiem.
- Vienmēr iepazīstieties ar attiecīgiem vietējiem un valsts ierobežojumiem un noteikumiem, un atbilstošiem iestādes protokoliem, pirms izmantojat jebkādu ierobežojuma siksnu vai ierīci.

Uz gultas komplekta atrodas astoņas pacienta ierobežošanas siksnu nostiprināšanas vietas, kurās piestiprināt pacienta ierobežošanas siksas (Attēls 19 vai Attēls 20).

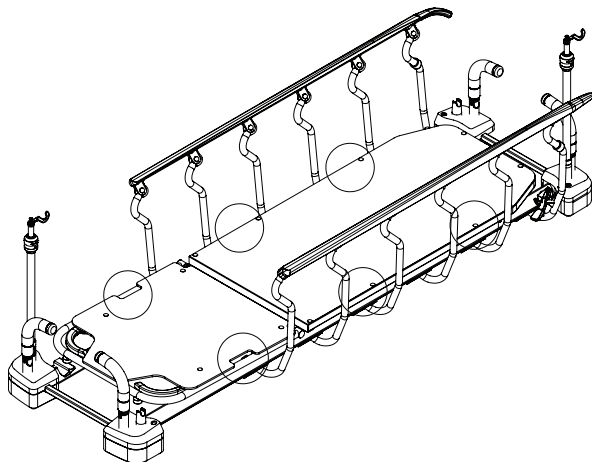

Attēls 19 – Ierobežošanas siksnu atrašanās vietas nestuvēs bez papildu rentgena iespējas

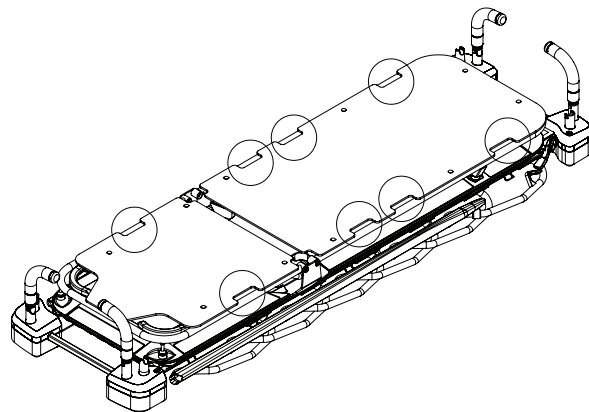

Attēls 20 – Ierobežošanas siksnu atrašanās vietas nestuvēs ar papildu rentgena iespējām

Piezīme - Ierobežošanas siksas ir B tipa pielietojamās daļas.

Rentgena kasešu ievietošana vai izņemšana


BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr pārļūkojiet piemērojamās vietēs un valsts drošības ierobežojumus un regulas, pirms lietojat rentgena papildu izvēli ar starojumu izdalošām ierīcēm. Starojumu izdalošās ierīces var radīt paliekošu, novirzījušu vai izkliedētu starojumu.
- Esiet vienmēr piesardzīgi, kad veicat rentgenuzņēmumu ar Faulera muguras balstu vertikālā stāvoklī vai izmantojat laterālu kaseti.

Rentgena papildu izvēle nodrošina gan radiogrāfijas atbalsta virsmu ar šarnīra pievienojumu, gan platformu zem pacienta atbalsta virsmas rentgena kasetes ievietošanai. Strādājot ar medicīniskām rentgena sistēmām, radiogrāfijas atbalsta virsma ļauj tvert klīniskas rentgenogrammas (anatomiju un fizioloģiju visam ķermenim, papildu izvēlē visam ķermenim laterāli, papildu izvēlē krūškurvim vertikālā stāvoklī), kamēr pacients atrodas uz izstrādājuma. Jūs varat ievietot kasetes no galvgaļa, kājgaļa vai abām izstrādājuma malām.

Lai ievietotu rentgena kaseti, rīkojieties šādi.

1. Iecentrējiet pacientu uz izstrādājuma ar pozīcijas etiķetēm visās izstrādājuma malās (Attēls 21).
2. Ievietojiet rentgena kaseti zem pacienta virsmas.

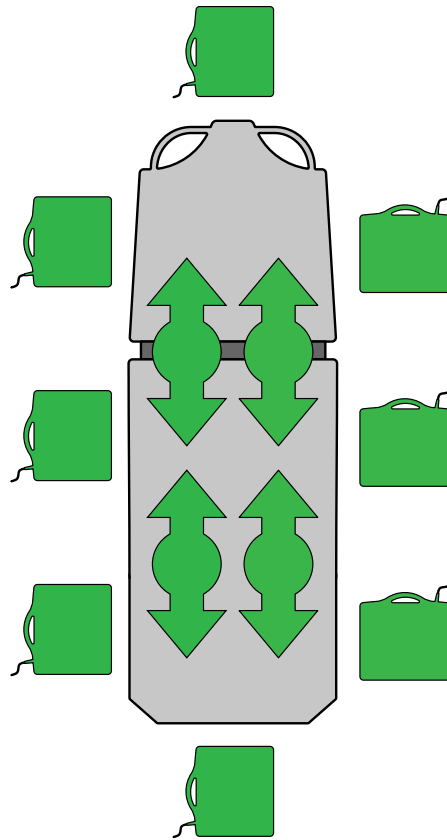

Attēls 21 – Rentgena kasešu ievietošana vai izņemšana

Piezīme

- Uz Stryker **ST1** modeļa un **ST1-X** sērijas nestuvēm vienmēr izmantojiet matraci 6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103 vai 6300-0-104.
- Nelietojiet C veida statni ar rentgena papildu izvēli. Rentgena papildu izvēle nav saderīga ar C veida statni.
- Maksimālie rentgena kasetes izmēri ir 35 cm x 43 cm x 2,5 cm.

Tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšana

Šie norādījumi sniedz ieteicamos tīrīšanas paņēmienus Stryker 6300 ST1 modeļa un ST1-X sērijas nestuvēm.

Šis izstrādājums ir mazgājams ar strūklu zem spiediena. No ilgstošas mazgāšanas izstrādājumam var parādīties dažas oksidēšanās vai krāsas maiņas zīmes. Tomēr no mazgāšanas ar ūdens strūklu zem spiediena izstrādājuma veiktspējas īpašības vai funkcionalitāte nepasliktināsies, ja vien tiks ievērotas pareizās procedūras.

Ieteicamais tīrīšanas paņēmiens

1. Noņemiet matraci no izstrādājuma.
2. Ievērojiet tīrīšanas šķīduma ražotāja ieteikumus par atšķaidīšanu.
3. Manuāli nomazgājiet visas izstrādājuma virsmas ar siltu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
4. Izvairieties no pārmērīgas izstrādājuma piesūcināšanas un pārlicinieties, ka tas nepaliek mitrs ilgāk nekā minēts tīrīšanas līdzekļa ražotāja pareizas tīrīšanas vadlīnijās.
5. Neuzlieciet matraci, kamēr izstrādājums nav sauss.
6. Pirms atdot izstrādājumu lietošanai, pārlicinieties, ka tas darbojas.
 - Paceliet un nolaidiet izstrādājumu
 - Nostipriniet un atbrīvojiet bremzēšanas/stūrēšanas pedāli abos stāvokļos
 - Nofiksējiet un atbloķējiet sānu balstus
 - Paceliet un nolaidiet Faulera muguras balstu
 - Pārlicinieties, ka visas sastāvdaļas ir pareizi ieeļļotas
 - Pārlicinieties, ka domkrats neiesprūst putekļu vai gružu dēļ
 - Pārlicinieties, ka visas etiķetes ir neskartas

Piezīme

- Tiešs ādas kontakts ar redzami nefīru, caurlaidīgu materiālu var palielināt infekcijas risku.
- Nefīriet izstrādājumu ar tvaiku.
- Notīriet pamatnes pārsega uzglabāšanas vietu.
- Nofīriet bremžu kluču apakšpusi, lai novērstu vaska vai grīdas palieku uzkrāšanos.
- Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Ja jūs pareizi nenošalojat un nenozāvējat izstrādājumu, koroziju izraisošo līdzekļu paliekas var palikt uz izstrādājuma virsmas, izraisot kritisku daļu pārāgru koroziju. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.

Joda traipu noņemšana

1. Pagatavojiet šķīdumu no 1-2 tējkarotēm nātrija tiosulfāta puslitrā silta ūdens. Izmantojiet šo šķīdumu notraipītās vietas noslaucīšanai.
2. Izfīriet traipus, cik ātri vien iespējams pēc to rašanās.
3. Ja traipi nepazūd tūlīt, ļaujiet šķīdumam iesūkties vai pastāvēt uz matrača pirms noslaucīšanas.
4. Pirms nodošanas lietošanai, noskalojiet matračus, kas apstrādāti ar šo šķīdumu, ar tīru ūdeni.

Piezīme - Šāda veida tīrīšanas līdzekļu lietošana, neievērojot šos norādījumus, var anulēt izstrādājuma garantiju.

Īpaši norādījumi

Velcro®	Piesūciniet ar dezinfekcijas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet šķīdumam iztvaikot.
Cietas vielas vai traipi	Lietojiet neitrālas ziepes un siltu ūdeni. Nelietojiet stiprus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Grūti iztīrāmas vietas	Grūti tīrāmiem plankumiem un traipiem lietojiet standarta mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus vai vinila virsmu tīrīšanas līdzekļus un mīkstu suku. Iepriekš samitriniet piekaltušos netīrumus.
Mazgāšana veļas mašīnā	Mazgāšana veļas mašīnā nav ieteicama. Mazgāšana veļas mašīnā var būtiski samazināt matrača kalpošanas ilgumu.

Matrača tīrīšana

Tīrīšana un dezinfekcija ir divi atsevišķi procesi. Pirms dezinfekcijas veiciet tīrīšanu, lai pārliecinātos, ka tīrīšanas līdzeklis ir efektīvs.

BRĪDINĀJUMS

- Nemazgājiet šī matrača iekšējās daļas. Ja piesārņojums iekļuvis iekšpusē, izmetiet matraci.
- Neiemērciet matraci tīrīšanas vai dezinfekcijas šķīdumos.
- Neļaujiet šķīdumam sakrāties uz matrača.
- Negludiniet, netīriet ķīmiski un nežāvējiet automātiskajos žāvētajos matrača pārvalku.

UZMANĪBU!

- Vienmēr lietojiet matrača pārvalku 6300-1-000 uz putuplasta pamatnes.
- Vienmēr noteikti noslaukiet izstrādājumu ar tīru ūdeni. Katru izstrādājumu pēc tīrīšanas nožāvējiet. Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.
- Nelietojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus ar agresīvām ķīmikālijām, jo tie samazinās matrača pārvalka sagaidāmo kalpošanas ilgumu.
- Tīrot matrača apakšējo daļu, neļaujiet šķīdumam iesūkties rāvējslēdzēja zonā vai ūdensnecaurlaidīgajā apmalē. Šķīdumi, kas saskaras ar rāvējslēdzēju, var iekļūt matrača iekšpusē.
- Pirms uzglabāšanas, gultas veļas uzklāšanas vai pacienta guldināšanas uz virsmas vienmēr ļaujiet matrača pārvalkam nožūt. Sausu izstrādājumu palīdz novērst tā pasliktinātu veiktspēju.

Veicot tīrīšanu un dezinfekciju, vienmēr ievērojiet slimnīcas tīrīšanas un dezinfekcijas protokolus.

Lai notīrītu matrača pārvalku, rīkojieties šādi.

1. Lai notīrītu no svešķermeņus, noslaukiet matrača pārvalku ar tīru, mīkstu, mitru drāniņu un vieglu ziepjūdeni.
2. Noslaukiet matrača pārvalku ar tīru, sausu drāniņu, lai notīrītu lieko šķīdumu vai tīrīšanas līdzekli.
3. Ļaujiet matrača pārvalkam izžūt.

Piezīme - Mazgāšana veļas mazgātājā nav ieteicama, jo tā var saīsināt matrača lietošanas ilgumu.

Izstrādājuma dezinfekcija

BRĪDINĀJUMS

- Neveiciet izstrādājuma tīrīšanu, apkopi, kā arī neveiciet remontu laikā, kad izstrādājums tiek lietots.
 - Netīriet izstrādājumu ar tvaiku, ūdens strūklu vai ultraskaņu. Šīs tīrīšanas metodes nav ieteicamas un var anulēt šī izstrādājuma garantiju.
-

Ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi

- Ceturtējie amonija sāļi (2100 m.d. aktīvās sastāvdaļas — amonija hlorīda) bez glikola ētera
- Hloru saturoša balinātāja šķīdums — 1000 m.d. aktīvās vielas
- 70% izopropilspirts (700 000 m.d.)

Ieteicamais dezinfekcijas paņēmiens

1. Ievērojiet dezinfekcijas šķīduma ražotāja ieteikumus par atšķaidīšanu.
2. Manuāli nomazgājiet visas izstrādājuma virsmas ar dezinfekcijas šķīdumu.
3. Izvairieties no pārmērīgas izstrādājuma piesūcināšanas un pārlicinieties, ka tas nepaliek mitrs ilgāk, nekā minēts dezinfekcijas līdzekļa ražotāja pareizas dezinfekcijas vadlīnijās.
4. Pilnībā nožāvējiet. Nelieciet atpakaļ matraci, kamēr izstrādājums nav sauss.
5. Dezinficējiet āķa un cilpas stiprinājumus pēc katras lietošanas reizes. Piesūciniet āķa un cilpas stiprinājumus ar dezinfekcijas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet dezinfekcijas līdzeklim iztvaikot (piemērotu dezinfekcijas līdzekli nosaka iestāde).
6. Pirms atdot izstrādājumu lietošanai, pārlicinieties, ka tas darbojas.
 - Paceliet un nolaidiet izstrādājumu
 - Nostipriniet un atbrīvojiet bremzēšanas/stūrēšanas pedāli abos stāvokļos
 - Nofiksējiet un atbloķējiet sānu balstus
 - Paceliet un nolaidiet Faulera muguras balstu
 - Pārlicinieties, ka visas sastāvdaļas ir pareizi ieeļļotas
 - Pārlicinieties, ka domkrats neiesprūst putekļu vai gružu dēļ
 - Pārlicinieties, ka visi marķējumi ir neskarti

Piezīme

- Tiešs ādas kontakts ar redzami netīru, caurlaidīgu materiālu var palielināt infekcijas risku.
- Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Ja jūs pareizi nenošalojat un nenozāvējat izstrādājumu, koroziju izraisošo līdzekļu paliekas var palikt uz izstrādājuma virsmas, izraisot kritisku daļu pāragru koroziju. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.

Matrača dezinfekcija

BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma un infekcijas riska, vienmēr dezinficējiet matraci saskaņā ar jūsu slimnīcas protokoliem.
 - Neiemērciet matraci tīrīšanas vai dezinfekcijas šķīdumos.
 - Neļaujiet šķīdumam sakrāties uz matrača.
 - Šī izstrādājuma dezinfekcijai neizmantojiet **Virex® TB**.
 - Neizmantojiet paātrinātas darbības ūdeņraža peroksīda dezinfekcijas līdzekļus vai četrvērtīgā amonija dezinfekcijas līdzekļus, kas satur glikolēterus, jo tie var bojāt matrača pārvalku.
-

UZMANĪBU!

- Vienmēr noteikti noslaukiet izstrādājumu ar tīru ūdeni. Katru izstrādājumu pēc tīrīšanas nožāvējiet. Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.
 - Pirms uzglabāšanas, gultas veļas uzklāšanas vai pacienta guldināšanas uz virsmas vienmēr ļaujiet matrača pārvalkam nožūt. Sausa izstrādājums palīdz novērst tā pasliktinātu veiktspēju.
 - Nepakļaujiet matrača pārvalku augstas koncentrācijas dezinfekcijas līdzekļu šķīdumu ilgākai iedarbībai, jo tie var bojāt matrača pārvalku.
 - Tīrot matrača apakšējo daļu, neļaujiet šķīdumam iesūkties rāvējslēdzēja zonā vai ūdensnecaurlaidīgajā apmalē. Šķīdumi, kas saskaras ar rāvējslēdzēju, var iekļūt matrača iekšpusē.
 - Nelietojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus ar agresīvām ķīmikālijām, jo tie samazinās matrača pārvalka sagaidāmo kalpošanas ilgumu.
 - Ja netiek ievēroti ražotāja tīrīšanas norādījumi un kompānijas Stryker lietošanas norādījumi, var tikt ietekmēts matrača kalpošanas laiks.
-

Ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi:

- četrvērtīgā amonija savienojumi, kas nesatur glikolēterus — 2100 m.d. aktīvās vielas
- hlora saturoša balinātāja šķīdums — 1000 m.d. aktīvās vielas
- 70% izopropilspirts (700 000 m.d.)

Veicot tīrīšanu un dezinfekciju, vienmēr ievērojiet slimnīcas tīrīšanas un dezinfekcijas protokolus.

Lai dezinficētu matrača pārvalku, rīkojieties šādi.

1. Pirms dezinfekcijas līdzekļu lietošanas notīriet un izžāvējiet matrača pārvalku.
2. Uzklājiet ieteicamo dezinfekcijas līdzekli ar iepriekš samitrinātām salvetēm vai mitru drāniņu. Nesamērcējiet matraci.

Piezīme - Pārliecinieties, ka ievērojat dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumus attiecībā uz atbilstošo saskares laiku un skalošanas prasības.

3. Lai noņemtu šķīduma vai dezinfekcijas līdzekļa atliekas, noslaukiet matrača pārvalku ar tīru, sausu drāniņu.
4. Ļaujiet matrača pārvalkam izžūt.

Profilaktiskā apkope

BRĪDINĀJUMS - Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, vienmēr apskatiet matraci. Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, ievērojiet slimnīcas protokolus un veiciet profilaktisku apkopi. Ja matracs ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un nomainiet izstrādājumu, lai neļautu rasties krusteniskajam piesārņojumam.

Pirms profilaktiskās apkopes veikšanas pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Veicot Stryker Medical izstrādājumu ikgadējo profilaktisko apkopi, pārbaudiet visus sarakstā uzskaitītos vienumus. Jums var būt nepieciešams veikt profilaktisko apkopju pārbaudes biežāk atbilstoši jūsu izstrādājuma lietošanas biežumam. Servisu uzticiet tikai kvalificētam personālam.

Piezīme - Ja nepieciešams, pirms apskates notīriet un dezinficējiet matrača ārpusi.

Apskatiet šādus elementus:

- _____ vai rāvējslēdzējā un pārvalkā (augšpusē un apakšpusē) nav plaisu, iegriezumus, caurumus;
- _____ vai atverot rāvējslēdzēju, matrača iekšējās daļās nav šķidrums iekļūšanas vai piesārņojuma pazīmju;
- _____ vai putuplasta un cita veida sastāvdaļas nav sadalījušās vai atdalījušās;
- _____ visi metinājumi;
- _____ visi stiprinājumi ir droši;
- _____ visi izstrādājuma marķējumi ir vietā un salasāmi;
- _____ visas metinājumu vietas (pamatnes rāmis, bremzes, gulta, domkrats, ratiņi, IV statņa locīklas metinājums un stumšanas roktura metinājums) ir nebojātas;
- _____ sānu balsti kustas un fiksējas;
- _____ sānu balsta fiksatori ir droši;
- _____ sānu balsts nav bojāts;
- _____ sānu balsta fiksators nav bojāts, fiksatora komplektā nav atskarpju vai gružu;
- _____ antistatiskais ritenītis nav nodilis vai bojāts;
- _____ ritenīši fiksējas, iedarbinot bremzēšanas pedāli;
- _____ ritenīši ir droši un grozās;
- _____ ritenīšos nav vaska un gružu;
- _____ ritenīši nav nodiluši vai bojāti;
- _____ ritenīša stiprinājuma savienojums nav bojāts;
- _____ ritenīši, bremzēšanas mehānisms un bremžu stienis nav bojāti vai saplaisājuši;
- _____ Faulera atbalsts ir paceļams, nolaižams un fiksējams vietā;
- _____ Faulera atbalsts nenoslīd vai negaidīti nekrīt;
- _____ Faulera atbalsta cilindriem nav noplūdes;
- _____ Faulera atbalsta gāzes cilindra stienis neiesprūst;
- _____ bremzēšanas/stūrēšanas pedāļi nav salocīti vai bojāti;
- _____ bremzēšanas mehānisms darbojas;
- _____ stūrēšanas mehānisms darbojas;
- _____ piektais ritenītis nav nodilis, vai bojāts un darbojas;
- _____ piektā ritenīša savienotājs nav salocīts vai pārāk izstiepts;
- _____ piektajā ritenītī nav uzkrājušies gruži vai vasks;
- _____ ratiņu tapa ir droša;
- _____ pamatnes rāmis nav bojāts;
- _____ sūkņa pedālis nav vaļīgs, nodilis vai bojāts;

- _____ hidrauliskā pacēlāja atbrīvošanas pedāļi nav vaļīgi vai bojāti;
- _____ domkrata atbrīvošanas vārstā nav putekļu, gružu, tas neiesprūst;
- _____ domkrata savienojumi nav zaudējuši iestatījumu, nav bojāti;
- _____ domkrata iestatīšanas vārsti un atspere darbojas;
- _____ domkrati nav bojāti;
- _____ galvgaļa un kājgaļa domkrati paceļas un nolaižas vienlaicīgi;
- _____ gulta paceļas un nolaižas no visiem stāvokļiem;
- _____ gultas sastāvdaļas ir vietā un nav bojātas (stiprinājums, fiksēšanas tapa, tapa, bukse nav izbīdīti, vaļīgi, izdiluši vai bojāti);
- _____ Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcija darbojas no visiem stāvokļiem;
- _____ pārbaudiet, vai apvalki nav saplaisājuši;
- _____ āķa un cilpas stiprinājums ir vietā, nebojāts un drošs;
- _____ Faulera atbalsts ir paceļams, nolaižams un fiksējams vietā;
- _____ Faulera atbalsta apakšsistēma (rokturis, stieple, pamatnes metinājums, cilindrs, stiprinājumi utt.) nav bojāta;
- _____ hidrauliskie domkrati ir stabili;
- _____ Faulera atbalsta stieple un mehāniskās sastāvdaļas netraucē viena otru;
- _____ hidrauliskiem savienojumiem nav noplūdes;
- _____ ieeļļojiet, kur vajadzīgs;
- _____ stumšanas rokturi nav vaļīgi vai bojāti;
- _____ ķermeņa ierobežotāji fiksējas, un ir droši (papildu izvēle);
- _____ IV statnis in neskarts, nebojāts un pielāgojams, un fiksējams visos stāvokļos;
- _____ skābekļa balona turētājs in neskarts, atverams un aizverams (papildu izvēle);
- _____ matrača pārsegam nav plīsumu vai plaisu;
- _____ piederumi un stiprināšanas ierīces ir labā stāvoklī.

Izstrādājuma sērijas numurs:
Aizpildīja:
Datums:


levelkamā piektā riteņa eļļošana

Nepieciešamie darbarīki:

- MPG-3 ziede
- Gumijas auklas

Procedūra

1. Paceliet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.

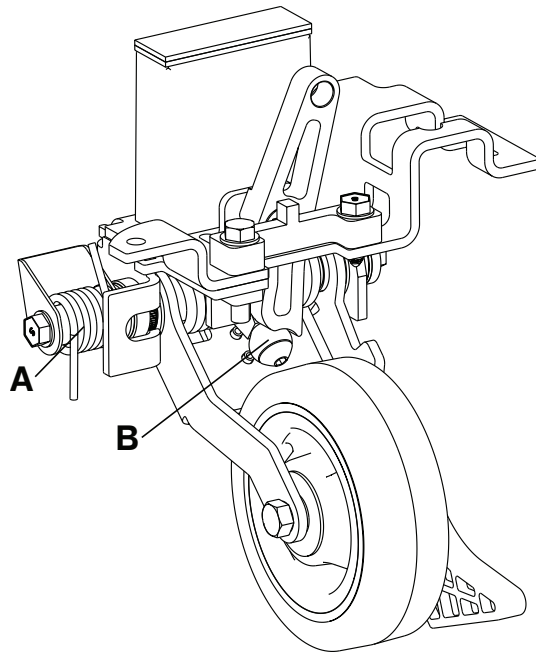

Attēls 22 – levelkamā piektā riteņa eļļošana

2. Paceliet pamatnes pārsegu un nostipriniet pārsegu ar gumijas auklām.
3. Uzklājiet MPG-3 ziedi atsperei (A) un ritenītim (B) (Attēls 22).
4. Noņemiet gumijas auklas un nolaidiet pārsegu.
5. Pirms nododat izstrādājumu lietošanai, pārlicinieties, ka tas pareizi darbojas.

stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA